




مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی			
مشخصات	حجم نمونه	مدل	نام دستگاه
شرکت Thermo Scientific آمریکا	-		نانودراپ (Nanodrop1000)
مشخصات مسئولین مربوط			
شماره تماس جهت هماهنگی	ناظر دستگاه	اپراتور دستگاه	
051-44013287	خانم دکتر صباغ زاده	آقای طزری	
نحوه ارائه خدمات			
برای هماهنگی زمان و سایر موارد با ناظر دستگاه و یا مسئول آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی به صورت تلفنی هماهنگ گردد.			نحوه هماهنگی جهت رزرو
<input checked="" type="checkbox"/> هزینه برای هر نمونه ۵۰,۰۰۰ ریال			نحوه مشارکت ناظر دستگاه

**تصویر دستگاه:**

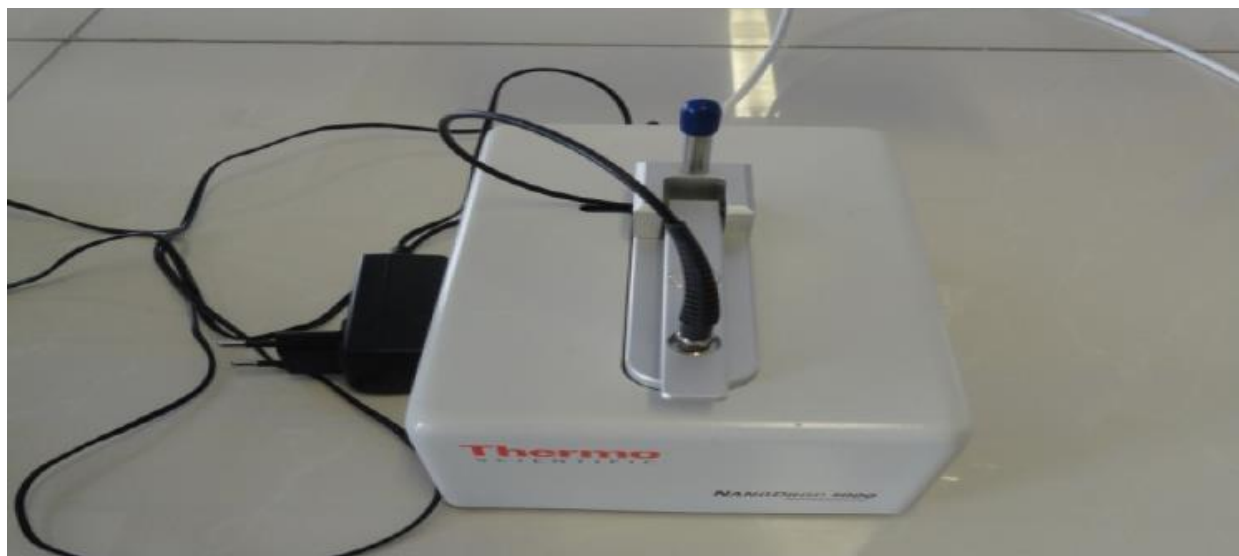

**توضیحات دستگاه:**

مبلغ دریافتی به ازای هر نمونه در طول موج های ۲۶۰ نانومتر و ۲۸۰ نانومتر است.